

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 września 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wyposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne videolaryngoskop renomowanej firmy o następujących parametrach :

- videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 2,4 cala ustawionym w stałej pozycji umożliwiającej dobrą widoczność podczas intubacji, z powłoką antyrefleksyjną,
- adapter wielorazowego użytku wyposażony w tor wizyjny z kamerą CMOS i źródło światła LED
- zasilany typowymi dostępnym powszechnie 3 bateriami AAA o czasie działania 80 minut, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż stosowanie specjalizowanych baterii litowo-jonowych oferowanych wyłącznie przez producenta , w zestawie 4 komplety baterii zapewniające czas pracy 320 min
- z wizualnym wskaźnikiem informującym za pomocą zielonej świecącej diody o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji,
- dostępne łyżki jednorazowego użytku czyste mikrobiologicznie, wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą, co znakomicie ułatwia intubację i eliminuje konieczność stosowania przewodnic oraz łyżki standardowej rozmiarze 1, 2 i 3 , w tym łyżki oznaczone przez producenta numerem 3, które dzięki specjalnej krzywiznie umożliwiają skuteczną intubację klasyczną jak i trudną intubację, w tym pacjentów u których wymagane jest stosowanie "klasycznych" łyżek w rozmiarze 4,
- waga wyświetlacza z bateriami 130 g, waga łyżki kanałowej 48 g
- videolaryngoskop z systemem gospodarowania energią , wyłączającym urządzenie po 1 min od odłożenia na nieruchomą powierzchnię,
- wbudowany port Micro-USB do przesyłania obrazu
- z wbudowanym automatycznym balansem bieli
- Videolaryngoskop jest trwały i odporny na mycie i dezynfekcję chusteczkami do dezynfekcji lub 70 % alkoholem izopropylowym,
- w zestawie 100 szt łyżek czystych mikrobiologicznie z kanałem lub standardowe do wyboru przez Zamawiającego wykonanych z ABS i poliwęglanu, etui do przechowywania urządzenia.

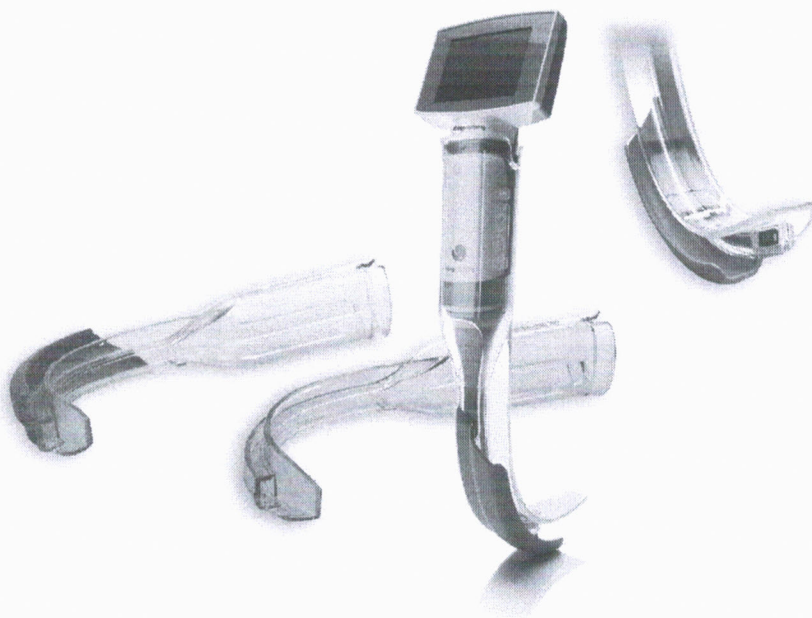

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie videolaryngoskopu o wyżej wskazanych parametrach.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk