

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Kalisz, dnia 25 kwietnia 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” - nr sprawy 17/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 6 (Ultrasonograf), Załącznik nr 1b – część A Formularza Ofertowego (7):

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie najwyższej klasy aparatu renomowanego producenta
- o liczbie kanałów przetwarzanie ultradźwiękowego wynoszącej 67392, różni producenci stosują różne kryteria ustalania tego parametru, zatem często nie jest on wyznacznikiem klasy aparatu,
 - o wadze 160 kg,
 - z możliwością regulacji wysokości konsoli o 15 cm,
 - wyposażony w pulpit sterujący o regulowanej pozycji w trzech płaszczyznach bez wspomagania silnikiem,
 - wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 2,0 - 6,0 MHz, o kącie pola skanowania 70 stopni i promieniu krzywizny 61 mm
 - wyposażony w głowicę endowaginalną o 192 elementach i kącie widzenia 176 stopni, zakresie pracy 4,0 - 9,0 MHz
 - wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5,5 - 18,0 MHz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultrasonografu jak wyżej proponuje wykonawca, z wyjątkiem głowicy endowaginalnej o wskazanych parametrach.

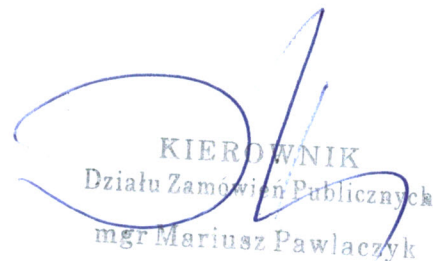
Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 6 (Ultrasonograf do diagnostyki pediatrycznej), Załącznik nr 1b – część C Formularza Ofertowego (7):

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie najwyższej klasy aparatu renomowanego producenta
- o dynamice 227dB
 - wyposażony w pulpit sterujący o regulowanej pozycji w trzech płaszczyznach bez wspomagania silnikiem,
 - z możliwością regulacji konsoli o 11 cm,
 - o maksymalnej głębokości penetracji 30 cm i bezstratnym powiększeniu obrazu 10x,
 - o szybkości odświeżania 120 fps,
 - o regulacji uchylności wiązki dopplerowskiej - 20 stopni,
 - o prędkości odświeżania dla CD 72 fps, regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego 20 stopni,
 - wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 1,4 - 5,0 MHz i promieniu krzywizny 62,5 mm, liczbie elementów 128, ale wykonanej w technologii Hanafy lens zapewniające ogniskowanie w 2 płaszczyznach, jak w głowicy matrycowej,
 - wyposażony w głowicę microconvex o 128 elementach,
 - wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,3 - 15,4 MHz, 192 elementach wykonanej w technologii Hanafy lens zapewniające ogniskowanie w 2 płaszczyznach, jak w głowicy matrycowej i szerokości czoła 34,6 mm - idealnej do badań pediatrycznych,
 - bez możliwości rozbudowy o fuzję i wgrywanie do aparatu obrazów z badań CT, MRI.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk