

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 04 kwietnia 2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**



INFORMACJA


Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych - sprawa nr 24/17.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie zbiorczym poz. 29 „Nakłuwacze automatyczne igłowe-głębokość nakłucia 1,8 mm, niebieskie, typu Medlance” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkości krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.

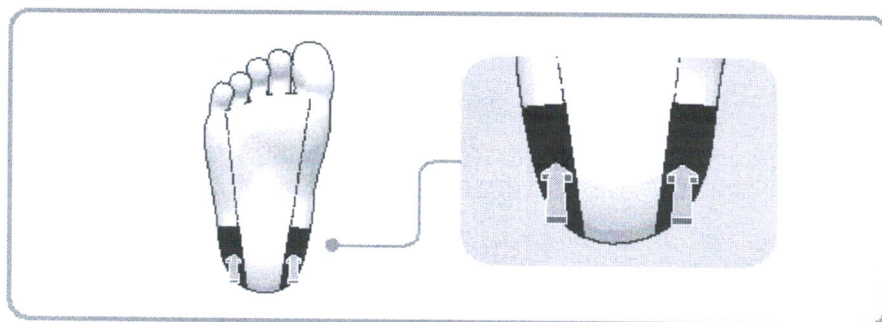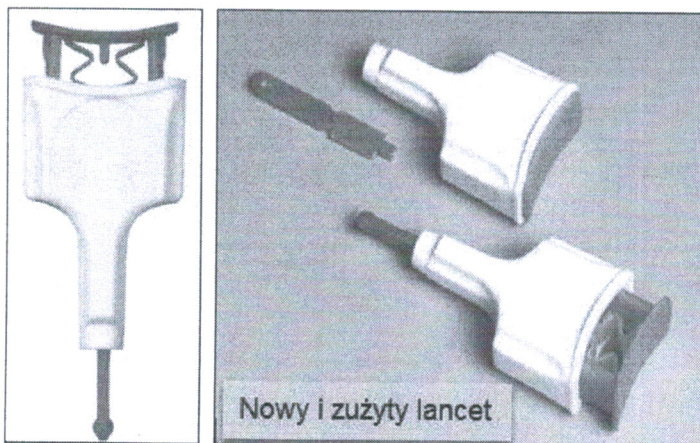

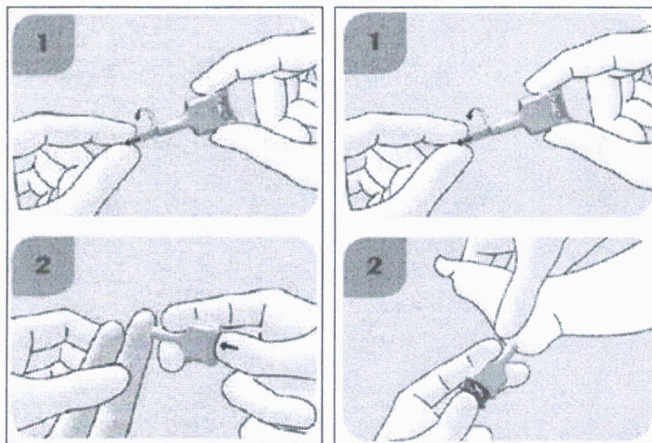

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający z Pakietu zbiorczego wydzieli poz. 29 „Nakłuwacze automatyczne igłowe-głębokość nakłucia 1,8 mm, niebieskie, typu Medlance.” do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie firm i otrzymanie najlepszej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wskazanej pozycji.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek