

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 września 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytania dotyczące Zadania Nr 6 pkt A – łóżko do intensywnej opieki medycznej – 5 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie opuszczonych i całkowicie podniesionych barierkach 97 cm? Oferowana szerokość jest szerokością całkowitą łóżka, bez względu na to, czy barierki są opuszczone, czy podniesione, ponadto jest to szerokość, która pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka przez drzwi o szerokości 1 metra.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające segmenty leża zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego segmenty leża zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 16 cm (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 16 cm (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn).

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające ograniczniki obejmujące materac (w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia) zapobiegające jego przemieszczaniu? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego ograniczniki obejmujące materac (w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia) zapobiegające jego przemieszczaniu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leżą w zakresie 0° – 12° ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację wszystkich elektrycznych funkcji dostępne z centralnego panelu sterowania dla personelu z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka z funkcjami selektywnej blokady oraz regulację podstawowych funkcji elektrycznych (regulacja wysokości, segmentu pleców i segmentu uda) dostępne obustronnie z panelu wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu oraz wewnętrznej dla pacjenta; wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52) zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję barierki bocznych umożliwiającą ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 różnych wysokościach (barierka podniesiona, barierka opuszczona), barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka?

Odpowiedź: : Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające uchwyty na akcesoria (4 haki) po każdej stronie łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego uchwyty na akcesoria (4 haki) po każdej stronie łóżka.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta.


W załączeniu do niniejszych wyjaśnień załączony do pytań przez wykonawcę opis techniczny.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

WIELOFUNKCYJNE ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ TERAPII Technoplus Advance

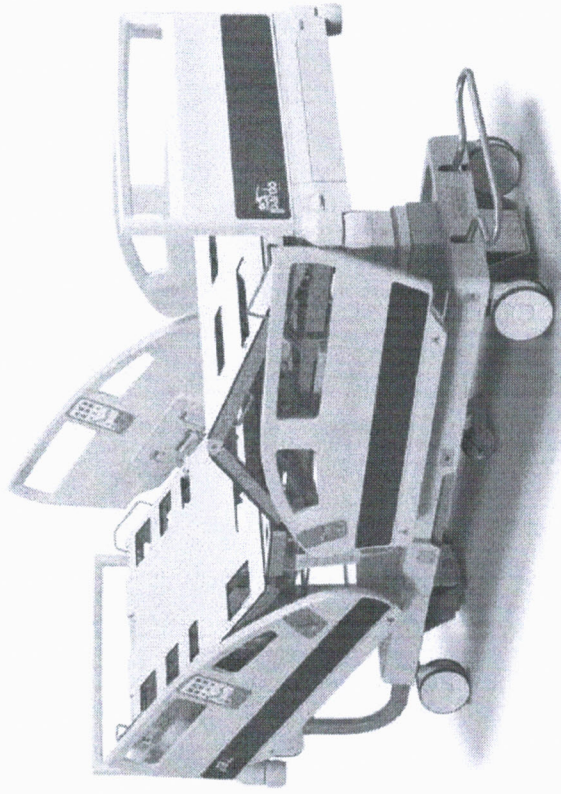

Łóżko może być wyposażone w zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta z wyświetlaczami wbudowanymi w barierki boczne. System posiadający następujące funkcje:

- Automatyczne tarowanie
- Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku)
- Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- Automatyczne kalibrowanie wagi
- Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
- Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g
- Alarm wyjścia pacjenta z łóżka
- Zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg
- Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”

Specyfikacja:


- Konstrukcja oparta na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, zapewniająca dużą stabilność łóżka oraz łatwe czyszczenie i dezynfekcję
- Leże 4 - sekcyjne (3 segmenty ruchome), wypełnione odedjmowanymi płytami HPL – łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji
- Segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG, wyposażony w prowadnice na kasety RTG
- Elektryczna regulacja wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja autokontur
- Cztery niezależne, opuszczane barierki boczne o wysokości 430 mm, wykonane z tworzywa, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża
- Barierki boczne z systemem spowalniającym opadanie, wspomagane sprężyną gazową
- Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i ramy leża – widoczne niezależnie od pozycji barierki
- Sterowanie elektryczne przy pomocy zintegrowanych, wbudowanych paneli sterujących dla pacjenta (od strony wewnętrznej) oraz dla personelu (od strony zewnętrznej): regulacja wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu uda - możliwość blokowania funkcji
- Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota: regulacja wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu uda, autokontur, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterujący wszystkimi funkcjami łóżka, przeznaczony dla personelu, zawieszany na szczyście łóżka od strony nóg, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji
- Pozycja kardiologiczna, CPR, pozycja antyszokowa, pozycja egzaminacyjna – regulowane za pomocą jednego oznaczonego przycisku na panelu sterowania dla personelu
- Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców
- Szczyty od strony głowy i nóg wykonane z tworzywa, wyjmowane, z możliwością blokowania np. na czas transportu łóżka, z wyprofilowanymi uchwytami ułatwiającymi prowadzenie łóżka
- Możliwość przedłużenia leża
- Podwójny system autoregresji zapobiegający powstawaniu odleżyn (160 mm)
- Centralna blokada kół oraz funkcja jazdy kierunkowej
- Podstawa wyposażona w tworzywową osłonę
- Klasa wodoodporności IPX6
- Dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg
- Krążki odbojowe w narożnikach łóżka chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami
- Możliwość wyboru koloru elementów dekoracyjnych na barierkach i szczytach
- Łóżko zgodne z normą EN 60601-2-52
- Uchwyty na worki na mocz po obu stronach leża

Parametry techniczne:


Max. długość (A)*	2200 mm (+/- 10 mm)
Max. szerokość (B)	970 mm (+/- 10 mm)
Regulacja wysokości (C i D)**	420 – 820 mm (+/- 5 mm)
Max. przedłużenie leża	300 mm
Prześwit pod łóżkiem**	163 mm
Długość leża (F, G, H, I)	790 / 170 / 320 / 620 mm
Szerokość leża (E)	830 mm
Kąt oparcia pleców (J)	0° – 70° (+/- 3°)
Kąt oparcia uda (K)	0° – 40° (+/- 3°)
Kąt oparcia podudzia (L)	0° – 12°
Kąt Trendelenburga i anty-Trendelenburga	18°/18°
Dopuszczalne obciążenie	250 kg
Waga łóżka	140 kg
Zasilanie	3A max./230V (+/-10%) 50/60Hz

*Długość zewnętrzna ze stałym szczytem 2240 mm (+/- 10 mm)

**Wysokość może się różnić o +/- 40 mm (w zależności od konfiguracji, wagi, rodzaju kot (t.p.))

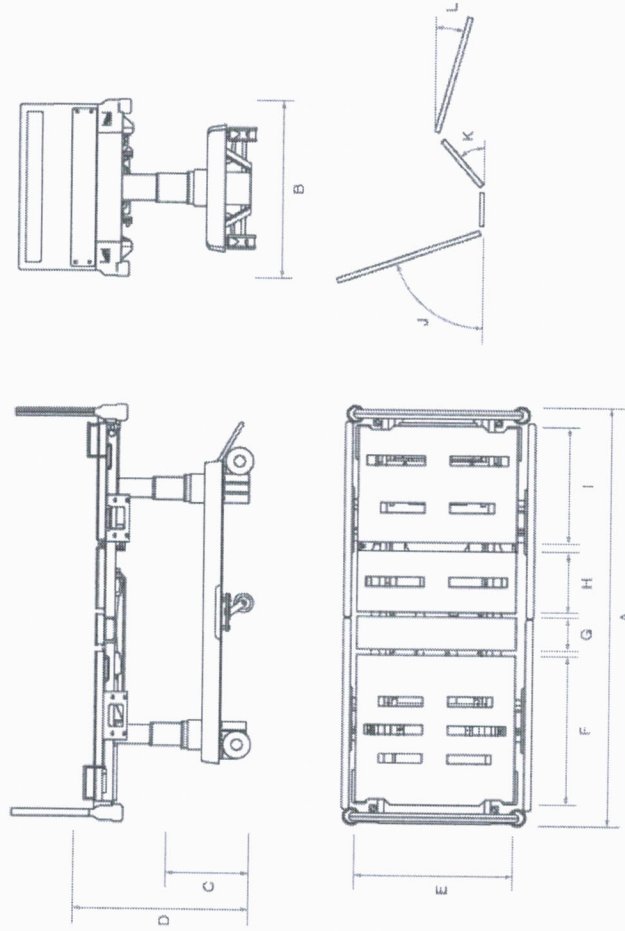

Wposażenie, dodatkowe opcje i akcesoria:

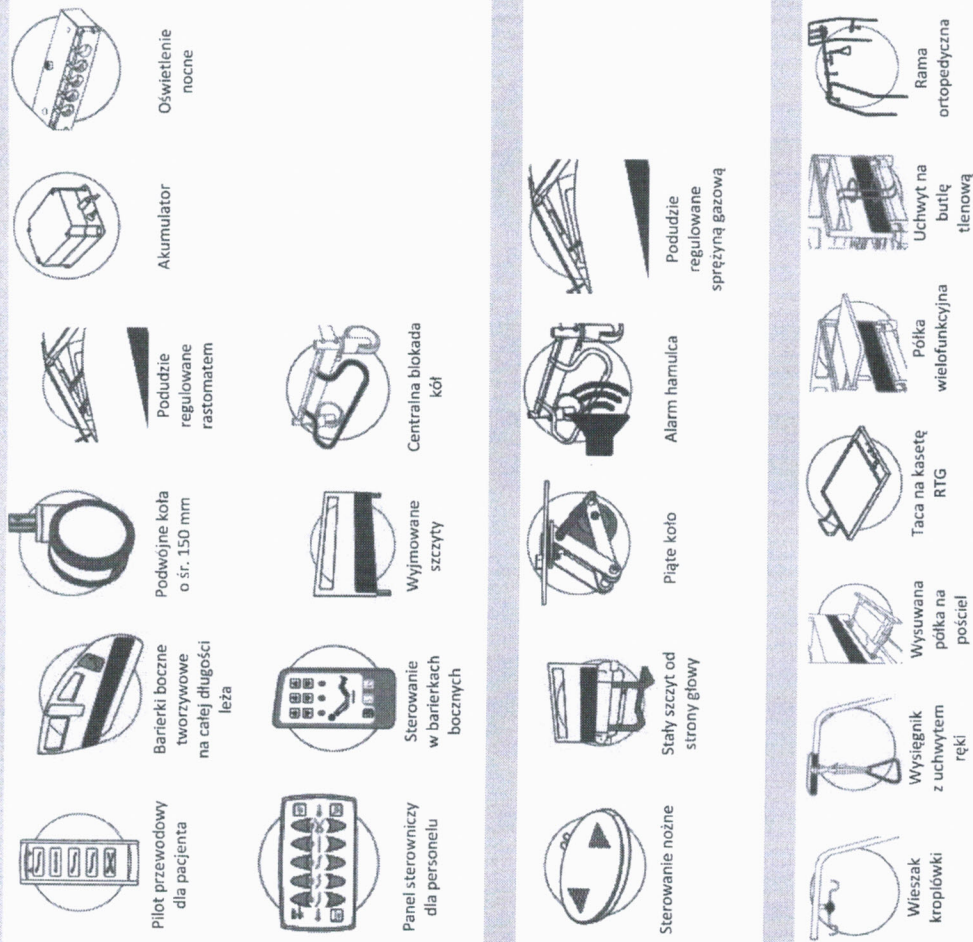

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.

www.prestige-med.com

Prestige – Med, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie