

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 02 sierpnia 2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego przy ulicy Toruńskiej 7 (sprawa nr 51/16)**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 - Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od dnia zawarcia umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia zawarty w SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z centralną blokadą kół w postaci elektromechanicznych wysuwanych nóżek, na których stół stoi podczas zabiegów – 4 nóżki wysuwane w skrajnych punktach podstawy niewystające poza jej obrys?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektrohydraulicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania stołu operacyjnego o napędzie elektrohydraulicznym.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego rama blatu wykonana jest z odlewanej stopu aluminium gwarantującego najwyższą wytrzymałość przy mniejszej masie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym poszczególne segmenty blatu montowane są za pomocą automatycznych zatrasków/szybkozłączy (bezpieczne połączenie „otwór-bolec”) umożliwiających szybki montaż i demontaż elementów składowych blatu bez potrzeby stosowania dodatkowych, niepraktycznych pokręteł? Pokręta są rozwiązaniem potencjalnie niebezpiecznym, gdyż personel może nieświadomie zapomnieć o ich dokręceniu, co może spowodować wypadnięcie segmentu. Oferowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczne połączenie segmentów blatu bez dodatkowych manipulacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym jeden zapasowy – pełniący funkcję sterownika awaryjnego, umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie wszystkimi wymaganymi funkcjami zamiast panelu sterującego umieszczonego na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół” co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dolnym położeniem blatu wynoszącym 650mm? Różnica zaledwie 10mm nie będzie zauważalna w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechyłami bocznymi wynoszącymi 20°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie od -35° do +70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 350kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny z centralną blokadą kół za pomocą dźwigni nożnej umożliwiającej uzyskanie: centralnej blokady stołu (stół stoi na kołach podczas zabiegu); funkcji do jazdy kierunkowej ułatwiającej przemieszczanie stołu w linii prostej; funkcji jazdy swobodnej we wszystkich kierunkach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny, który w pozycji zablokowanej stoi stabilnie na wbudowanych w podstawę nóżkach, po podniesieniu kół za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny, którego podstawa osłonięta jest odpornym na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne i łatwym w czyszczeniu tworzywem ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny, w którym płyta nożna (podnóżki) regulowana jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -100 do +55°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny z możliwością wyboru orientacji ułożenia pacjenta na pilocie zamiast na panelu bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny z regulacją wysokości blatu (bez materacy w zakresie od 670 do 1070mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny z przechyłami bocznymi wynoszącymi 18°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektromechaniczny stół operacyjny z podglówkiem regulowanym w zakresie +/-45° z pojedynczą regulacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z specjalnymi wytrzymałymi szerokimi kołami pojedynczymi o średnicy 80 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z centralną blokadą podstawy w postaci elektrohydraulicznie wysuwanych nóżek? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z nóżkami wysuwanymi pomiędzy pojedynczymi kołami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ i powszechnie stosowane w stołach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę z możliwością częściowego wsunięcia stóp operatora pod podstawę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy konstrukcyjne blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy w ramach wymogu zawartego w punkcie 10 tabeli technicznej, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem modułowym z możliwością montażu tylko płyty podgłówka i segmentów nóg z obu stron stołu do segmentu oparcia pleców oraz siedziska - co daje możliwość uzyskania znacznego wychylenia blatu w stosunku do kolumny stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z obsługą funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny zamiast elektromechanicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą nożną regulowaną za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem awaryjnego sterowania umieszczonym na kolumnie, który w celu aktywowania danej funkcji wymaga konieczności naciśnięcia przycisku aktywacyjnego a następnie wybrania żądanej funkcji - w celu uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podnóżków w zakresie od +30 stopni do -90 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka w zakresie od -90 stopni do +60 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w anestezyjologiczną ramkę ekranu metalową (sztywną) z możliwością ustawienia dowolnej żądanej pozycji dzięki zastosowaniu uchwytu wielopozycyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

do pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z kołami o średnicy 125 mm?

Proponowany parametr nie ma wpływu na walory użytkowe oraz funkcjonalność stołu, różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego a zapewnia taką samą mobilność stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

- do pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści system mocowania segmentów blatu z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwanym dźwignią? Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego a dodatkowo łatwiejsze i praktyczniejsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

- do pkt 21 – Czy Zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie +/- 45° z podwójną regulacją? – proponowany parametr nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu oraz możliwość pozycjonowania pacjenta podczas operacji a różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

- do pkt 22 – Czy zamawiający dopuści podnóżek regulowany w zakresie + 80° /- 90° w płaszczyźnie góra dół? – proponowany parametr nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu oraz możliwość pozycjonowania pacjenta podczas operacji a różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40, dotyczy pkt 3

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny o średnicy kół 80mm z ich centralną elektrohydrauliczną blokadą? Centralna blokada kół w postaci elektrohydraulicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Wysuwane nóżki są aktywnie wspierane przez funkcję auto poziomowania stołu? Rozwiązanie takie przy zastosowaniu dwóch wbudowanych akumulatorów daje efektywniejszą obsługę stołu, a wysuwane nóżki poza kołami gwarantują bezawaryjną pracę i w żadnym przypadku nie są w stanie zablokować kół jezdnych w przypadku uszkodzenia podnóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41, dotyczy pkt 4

Czy Zamawiający dopuści elektrohydrauliczny napęd stołu ? Rozwiązanie takie jest korzystniejsze i bezpieczniejsze w przypadku awarii stołu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42, dotyczy pkt 10

Czy Zamawiający dopuści system mocowania segmentów bez dodatkowego zabezpieczenia uzyskiwanego pokrętle? Oferowane mocowanie jest zatrzaskowe–stabilne, niewymagające dodatkowych pokręteł blokujących. Rozwiązanie takie w pełni gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika i jest dużo bardziej wygodne od wymaganego, prostsze i szybsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43, dotyczy pkt 11

Czy Zamawiający dopuści obsługę funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego sterującego układem hydraulicznym:

- regulacja wysokości;
- przechyły boczne;
- Trendelenburga / Antytrendelenburga,,
- płyta nożna,
- płyta plecowa,
- pozycja standardowa „0”,
- wysuwanie nóżek podwozia i
- dodatkowo funkcja Chair, Flex,
- przesuw poziomy

Dodatkowe funkcje dają więcej możliwości ułożenia pacjenta oraz zwiększają dostępność dla urządzeń diagnostycznych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44, dotyczy pkt 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość obsługi funkcji stołu z niezależnego panelu sterującego?
Panel awaryjny jest oddzielnym i niezależnym elementem stołu, co uniemożliwia ryzyko omyłkowego uruchomienia trybu awaryjnego znacznie zwiększając bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45, dotyczy pkt 13

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w panel do awaryjnego sterowania stołem w formie dodatkowego pilota zlokalizowanego w schowku na kolumnie od strony głowy. Aktywacja pilota następuje po wysunięciu dźwigni hydraulicznej dla ruchu awaryjnego (lewa strona podstawy stołu) co jednocześnie dezaktywuje pilot główny. Rozwiązanie takie daje wyjątkowe bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem trybu awaryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46, dotyczy pkt 17

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne regulowane w zakresie $\pm 20^\circ$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47, dotyczy pkt 21

Czy Zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie $+45^\circ/-90^\circ$ z podwójną regulacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 48, dotyczy pkt 22

Czy Zamawiający dopuści podnózek regulowany w zakresie $+30^\circ/-90^\circ$ w płaszczyźnie góra dół?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą przejezdną w kształcie litery T jak na załączonym poniżej rysunku?

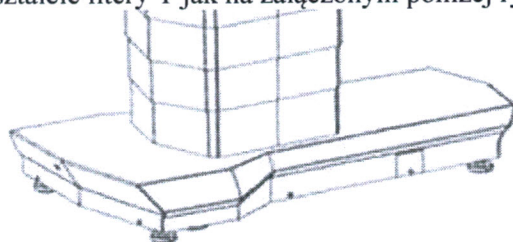

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z trzema kołami w tym dwa koła podwójne 125 mm, jedno koło obrotowe 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z system blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopiek gwarantujący pewne blokowanie stołu na czas operacji – stopki uruchamiane z pilota? Wysłunięcie stopiek powoduje podniesienie kół w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem mocowania segmentów za pomocą szybkozłączny sworzniowo/gniazdowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją płyty nożnej z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynną regulację segmentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym celu aktywowania danej funkcji z panelu do awaryjnego sterowania wymagane jest naciśnięcie przycisku włączającego panel a następnie naciśnięcie przycisku danej funkcji.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie +/-45°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pojedynczą regulacją podglówka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie -90°/+20°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją płyty plecowej w zakresie +80°/-30°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem 275 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Włodzimierz Szewczyk