

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 24 października 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestetycznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów – **znak sprawy 54/14**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 3 poz 1

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5-8F o długości 15 cm, 17cm, 20cm, 30cm (ta długość tylko dla 7-8Fr) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz 2

2. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-8F o długości 15 cm, 17cm, 20cm, 30cm (ta długość tylko dla 7-8Fr) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz 3

3. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-8F o długości 15 cm, 17cm, 20cm, 30cm (ta długość tylko dla 7-8Fr) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz 4

4. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-8F o długości 15 cm, 17cm, 20cm, 30cm (ta długość tylko dla 7-8Fr) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 4 poz 1

5. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 2-4F o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 4 poz 2

6. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3-4F o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 4 poz 3

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3-4F o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 4 poz 4

8. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5F o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 7 poz 13

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 w pozycji 13 dopuści łyżki jednorazowe do laryngoskopu typ Miller w rozmiarach 0 i 1 kompatybilne z uchwytami światłowodowymi zgodnymi z normą ISO 7376 tzw. „zielony standard”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz 1

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 w pozycji 1 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH₂O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz 4

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 w pozycji 4 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do punkcji opłucnej o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12 Ch, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych; strzykawka luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 13 poz 6

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 6 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm (zapewniając użytkownikowi większe bezpieczeństwo płynoterapii), posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 20 poz 1

13. Czy Zamawiający dopuści przewodnik ze sztywnym trzpieniem wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej PTFE typu 'J' 0,021; 0,025; 0,035; ,0,32; 0,038 o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania przewodnika zgodnego z SIWZ.

dotyczy zadania nr 23 poz. nr 1-13, 17-18

14. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w w/w pakiecie pozycji nr 1-13, i 17-18 ,oraz utworzenie odrębnego pakietu pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców, oraz zmniejszy koszt zakupu wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 23

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce paskowego mocowania pacjenta czapeczek o niższej podanych obwodach głowy.

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

dotyczy zadania nr 23 poz. nr 18

16. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 18 tj. komory nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 23

17. Czy Zamawiający wymaga aby układ był również funkcjonalny dla respiratora Fabian i posiadał złączkę do funkcji nCPAP o długości 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

18. Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów układu oddechowego w zakresie długości odcinka wdechowego, odcinka niepodgrzewanego do inkubatora oraz długości linii pomiaru ciśnienia. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się czy Zamawiający wymaga aby długość podgrzewanego odcinka wdechowego wynosiła 1,2 m? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do inkubatora posiadał długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 2,1m?

Odpowiedź: Nie są to warunki konieczne wymagane

19. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

dotyczy zadania nr 23 poz. nr 7 – 13

20. Prosimy o dopuszczenie czapeczki kompatybilnej z układem oferowanym w poz. 1 posiadającej mocowanie generatora w postaci trzech rzepów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 23 poz. nr 14 – 16

21. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czapeczek w miejsce paskowego mocowania?

Odpowiedź: TAK

dotyczy zadania nr 23 poz. nr 18

22. Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilżacza ograniczała gromadzenie kondensatu w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg H₂O/L?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

23. Dodatkowo proponowana komora posiada dren zasilający w wodę o dł. 1,2 m co zapewnia swobodę pracy personelu medycznego. Czy Zamawiający wymaga drenu do podaży wody o dł. 1,2m?

Odpowiedź: Nie jest to warunek konieczny wymagany.

24. Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym komory?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

dotyczy zadania nr 34

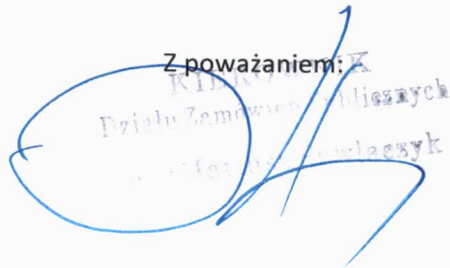
25. Prosimy o dopuszczenie zestawu pozbawionego trójkątnego wcięcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy zestaw ma posiadać kaniulę nosową?

Odpowiedź: TAK.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

Przewodniczący Komisji
Wykonawcy