

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 05 lipca 2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **Dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego przy ulicy Toruńskiej 7 (sprawa nr 40/16)**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 - Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 35 dni od dnia zawarcia umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia zawarty w SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z centralną blokadą kół w postaci elektromechanicznych wysuwanych nóżek, na których stół stoi podczas zabiegów – 4 nóżki wysuwane w skrajnych punktach podstawy niewystające poza jej obrys?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektrohydraulicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego rama blatu wykonana jest ze stopu aluminium, podstawa z żeliwa z osłonami z tworzywa ABS całej podstawy i kolumny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym poszczególne segmenty blatu montowane są za pomocą automatycznych zatrzasków/szybkozłączy umożliwiających szybki montaż i demontaż elementów składowych blatu bez potrzeby stosowania dodatkowych, niepraktycznych pokręteł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym jeden zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami stołu, bez dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół” co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dolnym położeniem blatu wynoszącym 650mm? Różnica zaledwie 10mm nie będzie zauważalna w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechyłami bocznymi wynoszącymi 20°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie od -35° do +70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy punktu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści stół z kołami o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół za pomocą wysuwanych nóżek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy punktu nr 10 – Czy Zamawiający dopuści stół, który nie ma możliwości montażu płyty plecowej podglówka i podnóżków po obu stronach stołu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy punktu nr 17 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym możliwość regulacji przechyłów bocznych wynosi 20°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy punktu nr 21 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym zakres regulacji podglówka jest w zakresie +/-45°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy punktu nr 22 – Czy Zamawiający dopuści stół w którym zakres regulacji podnóżków jest w zakresie $-90/20^0$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy punktu nr 23 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym zakres regulacji płyty plecowej jest w zakresie $-40/70^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy punktu nr 24 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 380kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19- PYTANIA DO SIWZ

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni ze względu na konieczność sprowadzenia stołu zza granicy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie 20

-dotyczy: pkt. 3 – Czy zamawiający dopuści koła o średnicy 125 mm? – oferowany parametr różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego a zapewnia taką samą mobilność stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

- dotyczy: pkt 10 - Czy zamawiający dopuści system mocowania segmentów blatu z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane dźwignią? – rozwiązanie to jest równoważne do wymaganego a dodatkowo łatwiejsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

- dotyczy pkt 21 – Czy zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie $\pm 45^0$ z podwójną regulacją? – proponowany parametr różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

- dotyczy pkt 22 – Czy zamawiający dopuści podnóżek regulowany w zakresie $+ 80^0 /- 90^0$ w płaszczyźnie góra dół? – oferowany parametr różni się tylko w nieznacznym stopniu od wymaganego i zapewnią pełną funkcjonalność podczas operacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

- Czy zamawiający dopuści stół o udźwigu do 280 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 120 mm z centralną blokadą w postaci uniesienia kółek powyżej podstawy stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści stół z zasilaniem tylko akumulatorowym i zewnętrzną ładowarką sieciową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści stół z zasilaniem sieciowym 230V (bez akumulatora)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści stół z zewnętrzną ładowarką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem przeziernym w zakresie $\frac{3}{4}$ długości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści stół bez funkcji wysuwania nóżek podwozia za pomocą pilota?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści stół bez dodatkowego panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem przewodowym bez sygnalizacji stanu naładowania akumulatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści stół z przechylem bocznym maks. 17°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści stół bez przesuwu wzdłużnego blatu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka w zakresie -45°/+35°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podnóżka w zakresie $-90^{\circ}/+35^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia w zakresie: $-4^{\circ}/+63^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia w zakresie $-16^{\circ}/+60^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści stół o dopuszczalnym obciążeniu 300 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści stół bez podpórki Geopla?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41, dotyczy pkt 3

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny o średnicy kół 80mm z ich centralną elektrohydrauliczną blokadą? Centralna blokada kół w postaci elektrohydraulicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Wysuwane nóżki są aktywnie wspierane przez funkcję auto poziomowania stołu? Rozwiązanie takie przy zastosowaniu dwóch wbudowanych akumulatorów daje efektywniejszą obsługę stołu, a wysuwane nóżki poza kołami gwarantują bezawaryjną pracę i w żadnym przypadku nie są w stanie zablokować kół jezdnych w przypadku uszkodzenia podnóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42, dotyczy pkt 4

Czy Zamawiający dopuści elektrohydrauliczny napęd stołu? Rozwiązanie takie jest korzystniejsze i bezpieczniejsze w przypadku awarii stołu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43, dotyczy pkt 10

Czy Zamawiający dopuści system mocowania segmentów bez dodatkowego zabezpieczenia uzyskiwanego pokrętle? Oferowane mocowanie jest zatrzaskowe –stabilne, niewymagające dodatkowych pokręteł blokujących. Rozwiązanie takie jest dużo bardziej wygodne od wymaganego, prostsze i szybsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, dotyczy pkt 11

Czy Zamawiający dopuści obsługę funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego sterującego układem hydraulicznym:

- regulacja wysokości;
- przechyły boczne;
- Trendelenburga / Antytrendelenburga,,
- płyta nożna,
- płyta plecowa,
- pozycja standardowa „0”,
- wysuwanie nóżek podwozia i
- dodatkowo funkcja Chair, Flex,
- przesuw poziomy

Dodatkowe funkcje dają więcej możliwości ułożenia pacjenta oraz zwiększają dostępność dla urządzeń diagnostycznych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45, dotyczy pkt 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość obsługi funkcji stołu z niezależnego panelu sterującego?

Panel awaryjny jest oddzielnym i niezależnym elementem stołu, co uniemożliwia ryzyko omyłkowego uruchomienia trybu awaryjnego znacznie zwiększając bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46, dotyczy pkt 13

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w panel do awaryjnego sterowania stołem w formie dodatkowego pilota zlokalizowanego w schowku na kolumnie od strony głowy. Aktywacja pilota następuje po wysunięciu dźwigni hydraulicznej dla ruchu awaryjnego (lewa strona podstawy stołu) co jednocześnie dezaktywuje pilot główny. Rozwiązanie takie daje wyjątkowe bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem trybu awaryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47, dotyczy pkt 17

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne regulowane w zakresie $\pm 20^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48, dotyczy pkt 21

Czy Zamawiający dopuści podglówek regulowany w zakresie $+45^0/-90^0$ z podwójną regulacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

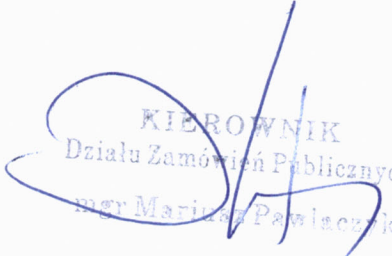
Pytanie 49, dotyczy pkt 22

Czy Zamawiający dopuści podnózek regulowany w zakresie $+30^0/-90^0$ w płaszczyźnie góra dół?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek