

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 18 czerwca 2015 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „**dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem**”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże na wysokości 500 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: TAK przy zachowaniu pozostałych wymagań/parametrów określonych w SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 74 stopni?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez kątomierzy w części wezgłowia po obu stronach leża?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją przechyłów wzdłużnych zwalnianą za pomocą wygodnego przycisku umieszczonego na ramie łóżka od strony nóg pacjenta, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją leża do pozycji anty-Trendelenburga w zakresie do 18 stopni?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez poziomicy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości na jednym ze szczelbli?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w krążki odbojowe tylko jednoosiowe zabezpieczające przed otarciami w trakcie zmiany pozycji horyzontalnej?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, mocowane po bokach do ramy leża za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża, pozostawiające wolną (bezpieczną dla pacjenta) przestrzeń pomiędzy szczytem a barierką, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne, ciągłe na całej długości leża, składane, mocowane po bokach do specjalnych dwóch wsporników pionowych, z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne, ciągłe na całej długości leża, składane, mocowane po bokach do specjalnych dwóch wsporników pionowych, z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, z poprzeczkami wykonanymi z aluminium, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z pewnym i solidnym osadzeniem bez potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed wypadnięciem?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg z potwierdzeniem przez producenta?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 26

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności potwierdzenia bezpiecznego obciążenia do min. 200 kg przez niezależny podmiot? Wymóg taki należy traktować jako nadmierny oraz sprzeczny z obowiązującym w tym zakresie prawem - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817) nie obejmuje wymaganego w SIWZ zaświadczenia. Zgodnie z dyrektywą medyczną i szczegółowymi normami medycznymi – producent który spełnia odpowiednie wymogi prawne, sam przeprowadza procedurę badań wyrobów, wydaje ocenę spełnienia tych norm i sam deklaruje zgodność parametrów i funkcji gotowego produktu, tak więc wymóg ten dotyczy jedynie tych wytwórców/producentów którzy nie posiadają możliwości wykonania samodzielnie takich badań i muszą zlecić wykonanie ich przez inny niezależny podmiot.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów...poz. 16” zapis: „potwierdzone przez niezależny instytut badawczy”.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik z uchwytem do ręki wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości na jednym ze szczebli?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac dostosowany do gabarytów leża łóżka o wymiarach 200x85x10 cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności wynikłej pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia wg tabeli „zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych” gdzie opisano poręcze z poprzeczkami z aluminium, a opisem przedmiotu zamówienia wg punktu B. SIWZ „opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne” gdzie wskazano, że należy zaoferować barierki boczne chromowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: słupki barierki wykonane ze stali malowanej proszkowo, poprzeczki barierki wykonane z aluminium.

Pytanie nr 31

W związku z naszym pytaniem nr 30, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: TAK

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

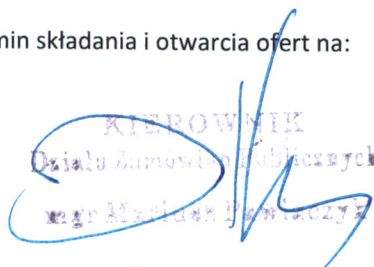
Jednocześnie Zamawiający informuje, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert na:

Termin złożenia – do godz. 9⁰⁰ dnia 24 czerwca 2015 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 24 czerwca 2015 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


KISPOWNIK
Dział Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Jaworski