

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dnia 27 listopada 2020 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Zakup urządzeń w ramach projektu

**„Program rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”
nr sprawy 77/20**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

1. Pytanie do zadania 21, formularz ofertowy (22), Aparat do krioterapii miejscowej.

Czy dopuszczą Państwo aparat ze zbiornikiem YDS 30 o pojemności 31,5 l o naturalnym samoistnym odparowaniu 12 dkg na dobę (0,15 litra). Zbiornik TR 35 ma pojemność 33,6 litra odparowuje z niego 0,24 litra na dobę (19 dkg). Termo stabilność zbiornika TR 35 wynosi 140 dni , a zbiornika YDS 30 (31,5 l) wynosi 208 dni.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie do zadania 21, formularz ofertowy (22), Aparat do krioterapii miejscowej.

Czy dopuszczą Państwo skokową (7 stopniową) regulację intensywności nadmuchu ponieważ przy płynnej regulacji zabiegi nie są powtarzalne. Ostatni aparat z płynną redukcją sprzedaliśmy w 2001 roku.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o długości 129 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o wysokości w pozycji złożonej 145 cm i maksymalnej wysokości roboczej – 214 cm, która umożliwia podnoszenie pacjenta z poziomu podłogi?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści podnośnik umożliwiający podnoszenie pacjenta z poziomu podłogi do maksymalnej wysokości od podłogi do uchwytu nosidła 184 cm (maksymalna wysokość robocza 214 cm)?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym II?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 53 kg?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym obciążeniu 215 kg?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o stopniu ochrony akumulatora IPX4 i pilota sterującego IPX7?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Pytanie do SIWZ, formularz ofertowy - załącznik nr 2B - - podstawowe warunki gwarancji i serwisu.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych, w przypadku aparatury produkcji polskiej i 21 dni roboczych w przypadku aparatury produkcji zagranicznej ? **UZASADNIENIE:**

Oczekiwanie zapewnienia czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, 5 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części zamiennych - jest fizycznie nie wykonalne szczególnie w przypadku urządzeń sprowadzanych z zagranicy, gdyż sam transport urządzeń zajmie więcej.

Należy też wziąć pod uwagę obecną sytuację związaną z panującą ogólnoswiatową pandemią i ryzykiem wprowadzania „lock-down'u” w kraju producenta danego urządzenia na co dostawca/wykonawca nie ma żadnego wpływu. Podtrzymanie takiego zapisu (3-5 dni) wymusi na dostawcach posiadania na stanie (dodatkowy zakup) urządzenia zastępczego a to z

kolei może oznaczać podwojenie kosztów dostarczenia urządzenia lub rezygnację z udziału w niniejszym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza (dla zadań 1-22) możliwość wydłużenia zapewnienie czasu naprawy: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, do 10 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części zamiennych.

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez wykonawcę rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego powyżej należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

11. Pytanie do zadania 10, formularz ofertowy (11), Urządzenie do wspomagania rehabilitacji chorych z zaburzeniem funkcji poznawczych, wspomagający trening pamięci, uwagi, treningu pola widzenia, planowania i logicznego myślenia, pkt 42 -55.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia spełniającego poniższy opis:

- urządzenie do testów uwagi słuchowej, badające sposób odbioru różnych częstotliwości drogą kostną i powietrzną,
- urządzenie skalibrowane z parametrami ustalonymi przez Alfreda Tomatisa i umożliwiające badanie z użyciem 35 częstotliwości.
- urządzenie do testów uwagi słuchowej - umożliwiające ustalenie u badanego progów słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową.
- zawartość zestawu: specjalistyczne oprogramowanie, słuchawki powietrzno – kostne, konduktor kostny, mikrofon, kabel USB, stacja robocza z ekranem dotykowym.
- wymiary urządzenia: 165 mm x 45 mm x 75 mm
- waga urządzenia : 300 g.

UZASADNIENIE

Urządzenie które Zamawiający opisał w pkt 42-55 zostało wycofane ze sprzedaży przez producenta, oraz zastąpione nowszym modelem (opisanym powyżej).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. Pytanie do zadania 15, formularz ofertowy (16), Stoły terapeutyczne do pracy z pacjentem neurologicznym pkt 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 tablicami terapeutycznymi - gdzie użytkownik wybiera (przed dostawą) 4 tablice z dostępnych 10 ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

13. Pytanie do zadania 22, formularz ofertowy (23), Stół do masażu, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulowanym zagłówkiem sprężyną gazową w zakresie -50° + 60°?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

14. Pytanie do zadania 22, formularz ofertowy (23), Stół do masażu, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulowanym kątem części środkowej: +20° ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

15. Pytanie do SIWZ, część B - Przedmiot zamówienia, pkt II i pkt III Obowiązki Wykonawcy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 31.01.2021 r ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

16. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Podnośnik transportowo-kąpielowy - Czy zamawiający wymaga do tego podnośnika podwieszki ? Jeżeli tak, to prosimy o sprecyzowanie : ilości, jakiego rodzaju oraz rozmiaru?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga na wyposażeniu podwieszek: uniwersalna (2 szt.) z podparciem głowy - do podnoszenia w pozycji siedzącej – rozmiar L i XL.

17. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Podnośnik transportowo-kąpielowy - Czy zamawiający dopuści podnośnik o masie (ciężarze własnym) 50 kg ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

18. Pytanie do zadania 5, formularz ofertowy (6), Podnośnik

Podnośnik transportowo-kąpielowy - Czy zamawiający w pozycji 11. Ma na myśli maksymalny dopuszczalny ciężar pacjenta do 205 kg ? wobec czego czy zamawiający dopuści podnośnik o bezpiecznym obciążeniu pacjenta 185kg

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli udźwig podnośnika min. 205 kg. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


19. Pytanie do zadania 1, formularz ofertowy (2), Bieżnia z możliwością odciążenia pacjenta

Czy zamawiający dopuści bieżnię Axelero I Reha oraz system dynamicznego odciążenia Eleveo, jak przedstawiono w załączonych kartach katalogowych?

ODPOWIEDŹ: Nie. Katalogi stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

20. Pytanie do zadania 2, formularz ofertowy (3), System Record-Therapy Master

Nazwa zadania wskazuje na inny produkt aniżeli opisany parametrami. Czy zamawiający dopuści zestaw Redcord Therapy Master o składzie jak niżej? Zestaw posiada dodatkowe akcesoria rozszerzające możliwość treningu funkcjonalnego. Jest to np. Aparat trener, który umożliwia łatwiejszą regulację długości liny z zamocowanymi akcesoriami. Aparat Axis umożliwiający pracę z rotacją oraz zwiększa wachlarz ćwiczeń funkcjonalnych.

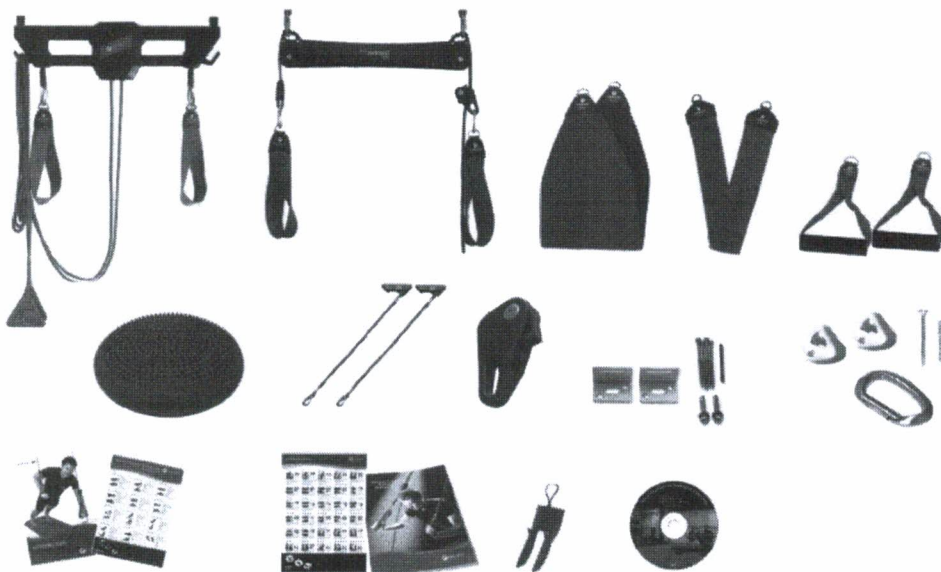

Zestaw Redcord Active Pro Plus to popularny system Redcord z aparatem Redcord Trainer, systemem podwieszek i akcesoriów, stanowiący profesjonalne rozwiązanie w treningu medycznym. Zestaw Active Pro Plus to szersza wersja zestawu Redcord Active Pro, zawierająca innowacyjny aparat Redcord Axis.

Aparat Trainer jest wyposażony w dwie, zakończone miękkimi uchwytami linki, do których montowane są podwieszki stanowiące podstawę optymalnego wykorzystania możliwości treningowych systemu Redcord Active Pro Plus. Aparat może zostać zamontowany bezpośrednio do sufitu (montaż do sufitu pozostaje w zakresie zamawiającego)

Zestaw Redcord Active Pro Plus to bezpieczne i niezawodne rozwiązanie treningowe, oferujące użytkownikowi setki możliwości ćwiczeń całego ciała.

Zestaw Redcord Active Pro Plus:

- 1x aparat AXIS,
- 1x aparat TRAINER,
- 2x podwieszka wąska,
- 1x podwieszka szeroka,
- 2x linka elastyczna 60 cm czerwona,
- 2x poduszka sensomotoryczna,
- 2x para uchwytów zwykłych,
- 1x para uchwytów POWER GRIP.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie do zadania 7, formularz ofertowy (8), Fotel do ćwiczeń oporowych

Czy zamawiający dopuści fotel o jednakowych parametrach funkcjonalnych z nieznacznymi różnicami jak niżej?

- Długość 168 cm
- Wysokość 155 cm
- Ciężarki 8 x 1 kg

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

22. Pytanie do zadania 16, formularz ofertowy (17), Łóżko pionizujące

Czy zamawiający dopuści łóżko pionizujące o parametrach jak niżej?

- **1-sekcyjny** stół do pionizacji z 2 niezależnie regulowanymi podnóżkami,
- łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego klucza do autoryzacji dostępu,
- 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
- funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
- zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w 16 wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
- system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania.

Dane techniczne	
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	190 x 69
Regulacja kąta pionizacji [°]:	0-87 (+3)
Regulacja wysokości [cm]:	53-103
Maksymalny udźwig [kg]:	200 (150 dla funkcji pionizacji)
Waga [kg]:	115



ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

23. Pytanie do zadania 19, formularz ofertowy (20), Aparat do terapii ultradźwiękowej

Czy zamawiający dopuści kozetkę bez regulowanej stopki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

24. Pytanie do zadania 9, formularz ofertowy (10), Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej

Czy zamawiający dopuści kozetki bez regulowanej stopki?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.


25. Pytanie do zadania 20, formularz ofertowy (21), Lampa Sollux

Czy zamawiający dopuści lampę z minimalnie różniącą się regulacją wysokości w zakresie 117 -176 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

26. Pytanie do zadania 22, formularz ofertowy (23), Stół do masażu

Czy zamawiający dopuści stół o lepszych parametrach jak niżej?

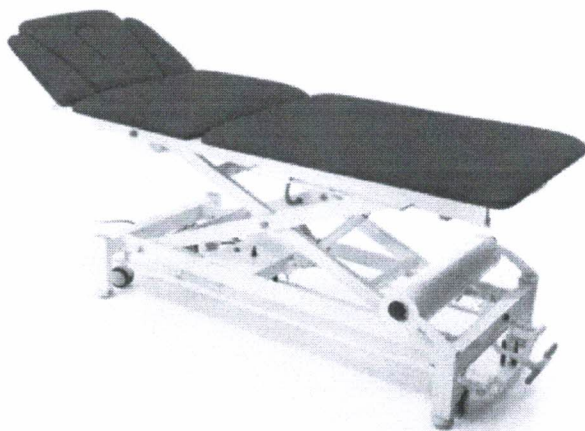

Cechy charakterystyczne:

- wygodna regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),
- system jezdny składający się z czterech kółek i 4 antypoślizgowych stopek,
- zagłówek z odpowiednio wyciętym otworem na nos i brodę z zaślepką otworu na twarz,
- kąt nachylenia poszczególnych części leża sterowany gazowymi sprężynami,
- pozycja pivota sterowana elektrycznie,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do $+90^{\circ}$),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- **SmartS4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji boczaków zagłówka, oparty o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczaków zagłówka w czasie terapii,
- uchwyty do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	205
Wysokość [cm]:	52-103
Szerokość [cm]:	64
Waga [kg]:	98/110
Obciążenie [kg]:	200

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

27. Pytanie do zadania 1, formularz ofertowy (2), Bieżnia z możliwością odciążenia pacjenta

Czy zamawiający dopuści zestaw składający się systemu odciążenia Ergotrainer (na szynie sufitowej [montaż do sufitu wykonywany przez zamawiającego] lub stelażu wolnostojącym – do wyboru przez klienta – opis w załączonej broszurze „Ergotrainer”) oraz bieżni medycznej „Axelero I Reha” (opis w załączonej broszurze). Podstawową zaletą systemu jest system dynamicznego odciążenia umożliwiający trening fizjologicznego wzorca chodu. System można stosować zarówno z bieżnią jak i prowadzić trening na stałym podłożu.

ODPOWIEDŹ: Nie. Broszura stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

28. Pytanie do zadania 1, formularz ofertowy (2), Bieżnia z możliwością odciążenia pacjenta

Czy Zamawiający dopuści urządzenie :

- pkt 2 - umożliwiające podnoszenie pacjenta z wózka inwalidzkiego bez możliwości podniesienia wózka inwalidzkiego,
- pkt 5 - bez wyposażenia w dwa dodatkowe, oddzielne panele sterujące, dostępne po obu stronach wysięgnika,
- pkt 11 - z kółkami jezdnyymi bez blokady,
- pkt 14 - bez mobilnego panelu sterowania,
- pkt 22 - z powierzchnią biegową (cm) 166 x 50,
- pkt 23 - z wymaganym miejscem (cm) 250 (+ 135 cm dla rampy dojazdowej) x150x260,
- pkt 24 - gdzie szerokość miejsca na wózek inwalidzki to (cm) 65,
- pkt 26 - z równoległymi poręczami medycznymi bez regulacji szerokości ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

29. Pytanie do zadania 2, formularz ofertowy (3), System Record-Therapy Master, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści :

- stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą przełącznika ramowego,
- stół z regulowanym zagłówkiem (z wycięciem na twarz) sprężyną gazową w zakresie -70° do + 40° ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

30. Dotyczy SIWZ, formularz ofertowy - załącznik nr 2B -zadania 1,4,10,13, 17, 18, podstawowe warunki gwarancji i serwisu.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń z instrukcją obsługi w języku polskim, menu urządzeń w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

31. Pytanie do zadania 9, formularz ofertowy (10), Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej , pkt 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez stopki umożliwiającej poziomowanie leżanki na nierównym podłożu?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

32. Pytanie do zadania 9, formularz ofertowy (10), Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej , pkt 33

Czy zamawiający dopuści aparat obsługujący głowice ultradźwiękową, pracująca na częstotliwościach 1 MHz/3 MHz ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

33. Pytanie do zadania 9, formularz ofertowy (10), Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej , pkt 41

Czy zamawiający dopuści aparat z sonde laserową IR 400mW/830nm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

34. Pytanie do zadania 9, formularz ofertowy (10), Aparat do elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękowej , pkt 46,47

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości ustawień dla aplikatora skanującego?
Zamawiający nie wymaga w wyposażeniu aplikatora skanującego w związku z tym podane parametry nie mają wpływu na obsługę aparatu.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

35. Pytanie do zadania 19, formularz ofertowy (20), Aparat do terapii ultradźwiękowej , pkt 20

Dotyczy poz. nr 20 – Czy zamawiający dopuści aparat z wypełnieniem w trybie pulsacyjnym 5%, 10%, 25%, 50 % ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

36. Pytanie do zadania 19, formularz ofertowy (20), Aparat do terapii ultradźwiękowej , pkt 21

Dotyczy poz. nr 21 – Czy zamawiający dopuści aparat z częstotliwością w trybie pulsacyjnym 10 Hz, 50Hz, 100 Hz, 150 Hz?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

37. Pytanie do zadania 19, formularz ofertowy (20), Aparat do terapii ultradźwiękowej pkt 26

Czy zamawiający dopuści aparat obsługujący głowice ultradźwiękową, pracująca na częstotliwościach 1 MHz/3 MHz ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

UWAGA

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert
określony w części H SIWZ:**

Jest:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia **30.11.2020 r.**

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia **30.11.2020 r.**

Powinno być:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia **02.12.2020 r.**

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia **02.12.2020 r.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek