

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28-06-2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na: „dostawę, montaż i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych”

nr sprawy: 37/16

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 Projekt umowy.

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 punkt 1 z 0,5% do 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie, to na jakie obniżenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 2 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 3 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 3 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z szynami technicznymi po bokach blatu (przy wszystkich segmentach blatu) ale bez szyn na ścianach kolumny stołu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 5 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawą w kształcie litery H, profilowaną dla dobrego dostępu dla stóp operatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 6 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawą o długości 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem wyposażonym w prowadnice na kasety RTG w segmentach: głowy, plecowym oraz siedzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 7 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem wyposażonym w prowadnice na kasety RTG o szerokości 390 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 9 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości 2035 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 9 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 12 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z funkcją przechyłów bocznych regulowaną mechanicznie, za pomocą składanej korby usytuowanej z boku stołu, pod segmentem siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 10 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 12 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z funkcją regulacji pozycji „flex” i „reflex” dokonywaną poprzez złożenie: regulacji pozycji anty i Trendelenburga oraz regulacji segmentu plecowego? Regulacje pozycji anty i Trendelenburga oraz segmentu plecowego sterowane są za pomocą sprężyn gazowych z blokadą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 11 Zadanie 2 – 2c – Stół zabiegowy – 2 sztuki.

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 14 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości blatu bez materaca od 695 mm do 995mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12 ZADANIE NR 2A, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 2SZT.

Dotyczy punktu nr 2 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która płynną i precyzyjną regulację płamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwyty ma w zakresie 17-30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13 ZADANIE NR 2A, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 2SZT.

Dotyczy punktu nr 7 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która ma 2 uchwyty brudne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 14 ZADANIE NR 2A, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 2SZT.

Dotyczy punktu nr 11 – Czy Zamawiający dopuści lampę, której stała temperatura barwowa wynosi 4 900 K?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 15 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści lampę, której głębokość oświetlenia wynosi 100cm?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 16 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy wynosi 38 000 lux?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 17 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 8 – Czy Zamawiający dopuści lampę, której żywotność żarówki wynosi 20 000h?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 18 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 9 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która nie posiada regulacji natężenia światła?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 19 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 10 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która regulację natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy ma na ramieniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 11 – Czy Zamawiający dopuści lampę, w której temperatura barwowa wynosi 4 800 K?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 21 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 12 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która współczynnik oddawania barw wynosi 94?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22 ZADANIE NR 2B, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: LAMPA ZABIEGOWA 1SZT.

Dotyczy punktu nr 14 – Czy Zamawiający dopuści lampę, która nie posiada brudnego relingu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 23 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 2 – Czy Zamawiający dopuści stół, który konstrukcję podstawy i kolumny ma wykonaną z trwałego ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 24 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym szyny akcesoryjne znajdują się po obu stronach każdej sekcji blatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 25 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 4 – Czy Zamawiający dopuści stół, który waży 125 kg? Oferowany parametr tylko minimalnie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 26 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 5 – Czy Zamawiający dopuści stół w kształcie pojedynczej litery Y?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 27 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym długość podstawy wynosi 1110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 28 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 8 – Czy Zamawiający dopuści tunel kasety RTG o szerokości 385mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 29 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 9 – Czy Zamawiający dopuści stół, który ma następujące wymiary: długość 2050mm, szerokość leża 600mm, szerokość z listwami 654mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 30 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 12,18 – Czy Zamawiający dopuści stół, który nie posiada osobnej pozycji flex/reflex?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 31 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 13 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji segmentu pleców jest w zakresie $-4/70^0$?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 32 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 15 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji Trendelenburga ma w zakresie 25^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 33 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 16 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji anty-Trendelenburga ma w zakresie 18^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 34 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 17 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji przechyłów bocznych ma w zakresie 15^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 35 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 19 – Czy Zamawiający dopuści stół, w którym podglówek ma zakres regulacji $-40/25^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 36 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 20 - Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji segmentu nóg ma w zakresie $-90/4^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 37 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Dotyczy punktu nr 22 – Czy Zamawiający dopuści stół, który dźwignie regulacji manualnych podglówka, podnóżków, pleców ma w kolorze czarnym i srebrnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 38 ZADANIE NR 2C, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: STÓŁ ZABIEGOWY

Czy Zamawiający wydzieli oddzielny pakiet na stół zabiegowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 39 Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie *1a. LAMPA BEZCIENIOWA – 3szt.* z zadania nr 1 i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru lamp spośród znacznie szerszego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 40 Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie *2a. LAMPA ZABIEGOWA – 2szt. i 2b. LAMPA ZABIEGOWA – 1szt.* z zadania nr 2 i utworzy dla tych pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru lamp spośród znacznie szerszego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 41 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o głębokości oświetlenia (L1+L2) wynoszącej 970mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 42 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 20 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie wymaganego natężenia tj. 60 000Lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 43 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z regulacją natężenia oraz włączaniem i wyłączaniem lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 44 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie 94?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 45 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 46 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1a. Lampa bezcieniowa – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w uchwyt sterylizacyjny oraz tzw. reling brudny okalający 50% obwodu czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 47 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 1, 1b. Fotel stomatologiczny – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela stomatologicznego z regulacją wysokości w zakresie od 45 do 85cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 48 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3700 do 5000°K (w 3 krokach: 3700, 4500, 5000°K) dzięki zastosowaniu diod w dwóch odcieniach emitujących światło homogenne bez tzw. „efektu tęczy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 49 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z płynną i precyzyjną regulacją średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w zakresie od 14 do 31cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 50 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z soczewkami wykonanymi z odpornego na zarysowania tworzywa poliuretanowego, połączonymi szczelnie z oprawą wykonaną z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 51 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której oprawa wyposażona jest w zintegrowane brudne uchwyty umożliwiające operatorowi pewne uchwycenie dłonią całej czaszy (konstrukcją monolityczną z czaszą), tak by w sposób precyzyjny ustawić kierunek padania wiązki światła niezależnie od położenia kopuły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 52 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie 95?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 53 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o zużyciu energii wynoszącej max 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 54 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2a. Lampa zabiegowa – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła wynoszącej max 40 000h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 55 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębokości oświetlenia (L1+L2) wynoszącej 970mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 56 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie wyższego natężenia tj. 60 000Lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 57 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oraz włączaniem i wyłączaniem lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 58 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stałą temperaturą barwową na poziomie 4500°K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 59 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie 94?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 60 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 61 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 2, 2b. Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w uchwyt sterylizacyjny oraz tzw. reling brudny okalający 50% obwodu czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 62 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 1

Czy Zamawiający dopuści; źródło światła czasza w kształcie deltoidu złożona z 52 białych diod led ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 63 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 2

Czy Zamawiający dopuści płynną i precyzyjną regulację średnicy plamy świetlnej d 10 w zakresie 12-22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 64 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie deltoidu przeznaczoną do współpracy z nawiewem laminarnym o współczynniku przepływu laminarnego poniżej 10% mierzonym zgodnie z normą DIN 1949-4 a tym samym będzie ten parametr jako równoważny punktował na max poziomie czyli 10 pkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 65 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści;

Matryca diodowa podzielona na dwie równe części. Podział realny, w którym obie części są od siebie fizycznie odseparowane (czasza dwuczęściowa (dwuogniskowa) z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami czaszy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 66 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 7

Czy Zamawiający dopuści pozycjonowanie kopuły za pomocą centralnego uchwytu w kopule oraz tzw reling brudny okalający około 25% obwodu czaszy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 67 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 11

Czy Zamawiający dopuści stałą temperaturę barwową 4300⁰ K?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 68 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 13

Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwolywania barwy czerwonej R9 równy 92?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 69 ZADANIE 2 - 1a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii 47W co niewiele odbiega od oczekiwań Zamawiającego bo tylko o 2 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 70 ZADANIE 2 - 2b. LAMPA ZABIEGOWA – 1 SZT

pkt 7

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 26 białych diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 71 ZADANIE 2 - 2b. LAMPA ZABIEGOWA – 1 SZT

pkt 14

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny oraz reling brudny okalający 25% obwodu czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 72 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 2

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjno-zabiegowy gdzie konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane są ze stali nierdzewnej a obudowa podstawy i górna obudowa kolumny wykonane są z bardzo wytrzymałego na odkształcenie kompozytu włókna szklanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 73 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści stół o masie własnej 172 kg .Większa masa stołu powoduje że jest on bardziej stabilny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 74 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu w kształcie z jednej strony litery Y , węższą w środkowej części tak aby umożliwić swobodny dostęp do stołu operatorowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 75 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 6

Czy Zamawiający dopuści stół o długości podstawy 1224mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 76 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 13

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu pleców w zakresie $-50^0/+60^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 77 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 14

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości bez materaca 600-950mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 78 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga 25^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 79 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 16

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji anty Trendelenburga 25^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 80 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT

pkt 17

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 15^0 w każdą stronę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 81 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 12,18

Czy Zamawiający dopuści stół bez łamania(wypiętrzenia) flex/reflex. Takie rozwiązanie jest stosowane raczej w stołach operacyjnych a nie zabiegowych np. do operacji nerki. W stołach operacyjnych jest to funkcja sterowana zazwyczaj elektrycznie ponieważ manualne sterowanie wypiętrzeniem flex/ reflex jest praktycznie niemożliwe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 82 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 20

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu nóg $-90^0/+0^0$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 83 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 21

Czy Zamawiający dopuści zakres odwodzenia segmentu nóg na boki 110^0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 84 ZADANIE 2 - 2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

pkt 22

Czy Zamawiający dopuści kolor dźwigni regulacji manualnych podglówka, podnóżków, pleców kolorem innym niż żółtym lub czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 85 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze średnicą pola roboczego wynoszącą: 18 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 86 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści średnicą pola roboczego wynoszącą: 14 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 87 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 3 w każdym po 3 diody LED – łącznie 9 ?
Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 88 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 5 w każdym po 3 diody LED – łącznie 15 ?
Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 89 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 8 w każdym po 3 diody LED – łącznie 24 ?
Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 90 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 91 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy odbywało się płynnie, bezdotykowo czujnikiem umieszczonym na czaszy w przedziale 15-100% zamiast panelu sterującego? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 92 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z temperaturą barwową 4750K ?
Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 93 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę o średnicy kopuły 21,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 94 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Płyta stropowa S3 – w załączeniu kopia dokumentacji (na końcu wyjaśnień).

Pytanie nr 95 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy występuje sufit podwieszany z czego , jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 96 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to proszę o podanie jakich przewodów oczekuje Zamawiający i jaka ma być ich długość.

Odpowiedź: W miejscu montażu nie ma przewodów do podłączenia lampy. Zamawiający oczekuje przewodów zasilających zgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta oferowanych lamp. Odległość od rozdzielni elektrycznej do miejsca instalacji wynosi ok. 40 m.

Pytanie nr 97 Zadanie nr 1 - 1a Lampa bezcieniowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny do pozycjonowania lampą. Przy tych gabarytach lampy takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające i daje pełny komfort użytkownikowi.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to proszę o dopuszczenie lampy wyposażonej w uchwyt brudny bez podania minimum okalającego czaszę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 98 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 3 w każdym po 3 diody LED – łącznie 9 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 99 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 5 w każdym po 3 diody LED – łącznie 15 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 100 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła 8 w każdym po 3 diody LED – łącznie 24 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 101 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z temperaturą barwową 4750K ?

Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 102 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy odbywało się płynnie, bezdotykowo czujnikiem umieszczonym na czaszy w przedziale 15-100% zamiast panelu sterującego? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 103 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze średnicą pola roboczego wynoszącą: 18 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 104 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści średnicą pola roboczego wynoszącą: 14 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 105 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z Wgłębnością oświetlenia 120 cm ?
Rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 106 Zadanie nr 2 - 2b Lampa zabiegowa - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny do pozycjonowania lampą. Przy tych gabarytach lampy takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające i daje pełny komfort użytkownikowi.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to proszę o dopuszczenie lampy wyposażonej w uchwyt brudny bez podania minimum okalającego czaszę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 107 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie ilość diod LED wynosi 60 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 108 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie zużycia energii jest na poziomie max 50 VA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 109 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z temperaturą barwową 4200K ?

Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 110 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie moduł oświetleniowy z diodami przykryty jest wytrzymałą płytą z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 111 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie CRI i R9 wynosi 95?

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 112 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie zużycia energii jest na poziomie max 80 W ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 113 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji średnicy pola bezcieniowego w przedziale 18-28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 114 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści oprawy lampy wykonane z tworzywa sztucznego gdzie przyrost temp. wynosi ok. 1⁰C ? Obudowa czasz lampy nie musi być wykonana z ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi żeby odpowiednio odprowadzić ciepło.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 115 Zadanie nr 2 – 2a Lampa zabiegowa - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie pozycjonowanie kopuły dokonuje się przy pomocy centralnie umieszczonego uchwyty, bez uchwytów brudnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 116 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyodrębni osobny pakiet 2b (lampa zabiegowa 1 sztuka). Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców przez co zwiększy się konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 117 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 60 dni? Pozwoli to na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 118 Zadanie nr 2 – poz. 5

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia 70 cm? Przy lampie zabiegowej o jednej czaszy oferowany parametr gwarantuje komfortowe przeprowadzanie badań przez personel medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 119 Zadanie nr 2 – poz. 12

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku oddawania barw CRI 93? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i może być uznany za równoważny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 120 Zadanie nr 2 – poz. 13

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy płamy świetlnej pola w odległości 1 m od czoła lampy 120 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na dobrą jakość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 121 Zadanie nr 2 – poz. 14

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt zdejmowany nadający się do sterylizacji? Parametr nieznacznie różni się od podanego, a dodatkowo w zapasie dołączamy drugi uchwyt zapasowy co podnosi korzystność podanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 122 Dotyczy: lampy bezcieniowa – 3 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą w kształcie wieloboku na bazie trójkąta o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 34x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 123 Dotyczy: lampy bezcieniowa – 3 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której układ optyczny składa się z 6 reflektorów po 3 diody LED każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 124 Dotyczy: lampy bezcieniowa – 3 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia w zakresie 41-100%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 125 Dotyczy: lampy bezcieniowa – 3 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez relingu brudnego? Wymiary oraz waga czaszy pozwalają na jej bezproblemowe manewrowanie za pomocą uchwytu sterylnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 126 Dotyczy: lampy zabiegowej – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze skokową regulacją wielkości płamy świetlnej w zakresie 16-25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 127 Dotyczy: lampy zabiegowej – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z jednosegmentową matrycą świetlną zabezpieczoną od strony świetlnej szybą ze szkła bezpiecznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 128 Dotyczy: lampy zabiegowej – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z diodami świecącymi z różną intensywnością podczas regulacji natężenia światła? Sposób realizacji zmiany natężenia oświetlenia

nie ma wpływu na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 129 Dotyczy: lampy zabiegowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której układ optyczny składa się z 6 reflektorów po 3 diody LED każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 130 Dotyczy: lampy zabiegowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oraz funkcją włącz/wyłącz realizowaną z dwóch różnych miejsc (na dwóch przegubach) tuż przy czaszy lampy? Takie rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 131 Dotyczy: lampy zabiegowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze barwowej wynoszącej 4500 K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 132 Dotyczy: lampy zabiegowej – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez relingu brudnego? Wymiary oraz waga czaszy pozwalają na jej bezproblemowe manewrowanie za pomocą uchwyty sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 133 Dotyczy: zapisów SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na połączenie zadania nr 1 i zadania nr 2 w jeden pakiet, co umożliwi złożenie oferty przez jedną firmę w konkurencyjnej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 134 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową LED, której żywotność diod led wynosi 20000 h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 135 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową LED, której współczynnik Ra wynosi 90?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 136 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową LED o stałej temperaturze barwowej 3700 K ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 137 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści stol zabiegowy z segmentem nożnym jednoczęściowym, płytowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 138 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy niewyposażony w tunel kasety rtg. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.


Pytanie nr 139 Dotyczy: Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenia powystawowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

W przypadku zaoferowania asortymentu zgodnego z powyższymi odpowiedziami, zaoferowane parametry należy wpisać w kolumnie „Oferowane parametry” tabeli znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2) lub Formularzu Ofertowym (3) w siwz str. 21 - 28.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

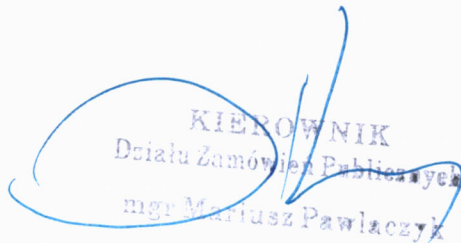
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk

Płyta stropowa /str. 37 obłożen/

W trakcie CD, w części łózkowej, na kondygnacji 6-11.


Rw = 200 at, Qr = 4200 at.

Użytkowe w pok. łózkowych = 150 kg/m²,

podłogi wg projektu = 90 "

Żebra obrożne

$l_o = 5,40 \text{ m}$

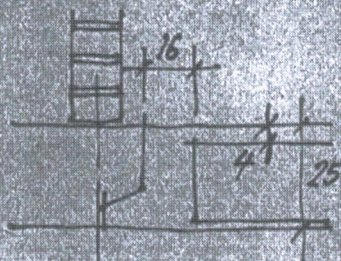

Obciążenia:

wg projektu

797 kg/m

wzrost ciężaru posadzek

wg obl. na str. 2.

= / 192 - 90 / . 0,59 = 60 "

857 kg/m

/wzrost 8 %/

$$M = 857 \cdot \frac{5,40^2}{8} = 3120 \text{ kgm}$$

$b \times h = 16 \times 25 \text{ cm}, b_d = 36 \text{ cm}; h_o = 22$


$$A = \frac{3120 \cdot 1,6}{0,36 \cdot 22^2} = 28,65 \quad \mu = 0,75\%$$

$$F_z = 0,75 \cdot 0,36 \cdot 22 = 5,94 \text{ cm}^2$$

$$\text{wg projektu } 3 \text{ Ø } 16 \quad 34 \text{ GS} = F_z = 6,03 \text{ cm}^2$$

Żebra pośrednie

$l_o = 5,40 \text{ m}$

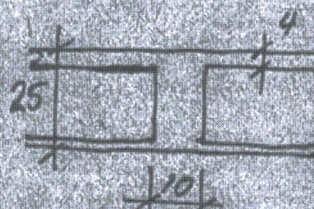

Obciążenia:

wg projektu

= 375 kg/m

wzrost 102 . 0,60 =

61 "

/wzrost 16%/

436 kg/m